



Prezados (as), responsáveis pelos pedidos de ressuprimento de testes rápidos,

Em nome do Programa Municipal DST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo, considerando a necessidade de melhorar a qualidade do dado referente aos estoques, solicitamos que verifiquem o estoque físico da sua unidade e as informações inseridas no sistema (<http://sisloglab.aids.gov.br/>) e façam os devidos ajustes, para que possamos padronizar as informações.


- 1) As unidades devem inserir os dados no primeiro dia útil de cada mês (no máximo até o 5º dia útil).

O **ressuprimento** da unidade dependerá dos dados inseridos no SISLOGLAB - **MAPA**, da data da inserção e a partir daí do cronograma do abastecimento do almoxarifado.

Considere no estoque final apenas o Kit fechado e deve-se dar baixa quando o kit é aberto no item consumido.

Sendo assim, o total de Kits em estoque do sistema reflete no pedido final.

Veja abaixo algumas ilustrações do Sistema:

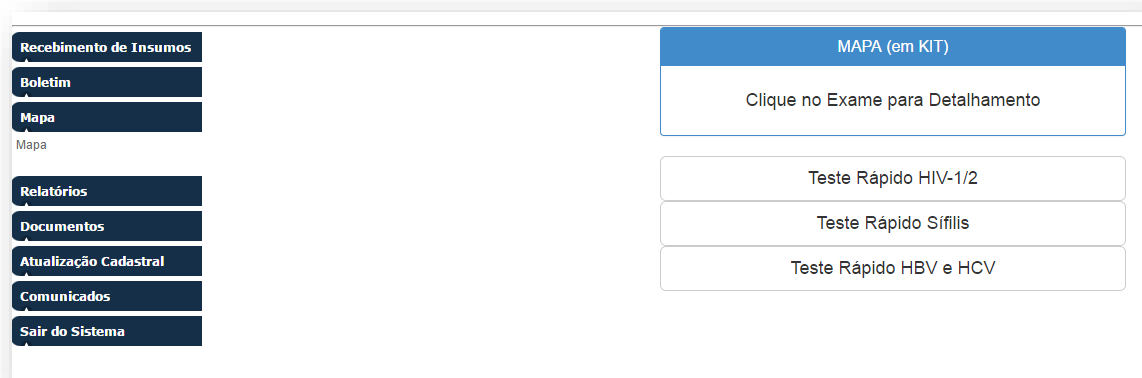

- Relatórios
- Documentos
- Atualização Cadastral
- Comunicados
- Sair do Sistema

Função: _____

E-mail: _____

Telefone: _____

Telefone Celular: _____

Data do Preenchimento:* _____

Data do Fechamento: _____

Observação: _____

Confirmar

**Confirmar e acessar
separadamente cada um dos
Insumos para regularizar o
ESTOQUE**

Insumos	Saldo Inicial	Entradas		Consumo	Saídas			Saldo Final	Ressuprimento	
		Receb.	Reman.		Reman.	Ajust.	Perda		Rotina	R.Cegonha
Teste Rápido DPP HIV 1/2 - (20 testes) - FIOCRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teste Rápido HIV - Fluido Oral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Teste Rápido Bioeasy HIV 1/2 (25 testes) Alere	0	0	0	2	0	0	0	2	3	3
Teste Rápido Bioclin HIV Tri Line (kit com 25 testes) - QUIBASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mapa Fechado com Sucesso!!!

Imprimir Relatório

- Recebimento de Insumos
- Boletim
- Mapa
- Relatórios
- Documentos
- Atualização Cadastral
- Comunicados
- Sair do Sistema

**MAPA (em KIT)
Teste Rápido HIV-1/2**

Mês de Referência	Situação
Maio/2017	Indisponível
Abril/2017	Fechado
Março/2017	Fechado
Fevereiro/2017	Fechado
Janeiro/2017	Fechado
Dezembro/2016	Fechado
Novembro/2016	Fechado
Outubro/2016	Fechado
Setembro/2016	Fechado
Agosto/2016	Fechado
Julho/2016	Fechado
Junho/2016	Fechado

Recebimento de Insumos

Boletim

Mapa

Relatórios

Documentos

Atualização Cadastral

Comunicados

Sair do Sistema

Mapa Mensal Teste Rápido HIV-1/2

Teste Rápido Bioeasy HIV 1/2 (25 testes) Alere

Saldo Inicial: 1 ? (Saldo Final do mês anterior)

Entradas (KIT)

Recebido: 0 ? (Soma dos KITS recebidos no menu "Recebimento de Insumos")

Remanejado: 0 ?

Ajuste: 3 ? Kit em estoque

Saídas (KIT)

Consumido: 2 ?

Remanejado: 0 ?

Ajuste: 0 ?

Kits Perdidos

Quantidade	Motivo da Perda	Nº do Lote	Total
0			0

Inserir

Saídas			Saldo Final	Ressuprimento	
Reman.	Ajust.	Perda		Rotina	R. Cegonha
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1


Te

Te

Descrição do Motivo da Perda (Outros)

A seguinte tela abrirá para que seja feito o ajuste do estoque.

Lembramos que **O estoque** deve ser feito por **KITS (caixas)** e **NÃO por testes**.

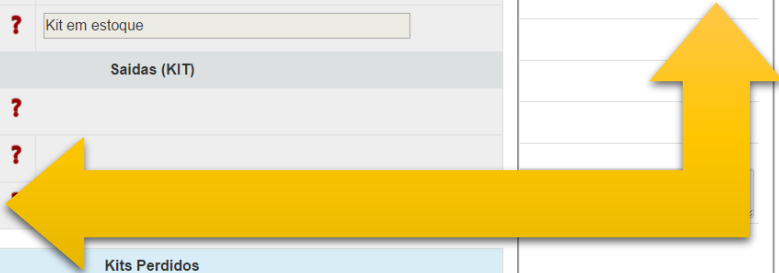

- 2) O **Preenchimento do Boletim** indica a sua produção- número de testes realizados. No primeiro campo: **testes reagentes**, que se refere ao número de testes positivos T1; O T2 = número de testes positivos com o T2. Geralmente o número de T1 e T2 são iguais, isto é, são concordantes. Números de testes discordantes T1 e no T2 significa que há problemas.

Inserir no Boletim conforme imagem abaixo:

Mapa

Relatórios

Documentos

Atualização Cadastral

Comunicados

Sair do Sistema

Telefone: (11)2977-7739

Telefone Celular: (11)2977-7739

Data do Preenchimento: 01/05/2017

Data do Fechamento: 01/05/2017

Observação:

Número de Testes **REAGENTES**

Testes de **Triagem Reagentes** para HIV (T1) Independente do Fabricante: 11

Testes **Confirmatórios Reagentes** para HIV (T2) Independente do Fabricante: 11

Confirmar

*Campos Obrigatórios

Insumos	Rede Cegonha	Mobilização	Treinamento	Rotina	Total	Invalidos	Perdidos
Teste Rápido DPP HIV 1/2 - (20 testes) - FIDORUZ	0	0	0	11	11	0	0
Teste Rápido HIV - Fluido Oral	0	0	0	0	0	0	0
Teste Rápido Bioeasy HIV 1/2 (25 testes) Alere	0	0	0	118	118	0	0
Teste Rápido Blood HIV Tri Line (88 com 25 testes) - QUABASA	0	0	0	0	0	0	0

Boletim Fechado com Sucesso!!!

Imprimir Relatório

Suporte - sisloglab@saids.gov.br - 0800-612439 Opção 2

Agradecemos vossa compreensão e colocamo-nos a disposição no caso de eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.